


[Accueil](#)
[Syst'am](#)
[Produits](#)
[Contact](#)
[News](#)

● Polyplot®


Indications

- Risque d'escarre FAIBLE à MOYEN selon grille d'évaluation validée.

Les "PLUS" produit

- **Indépendance et mobilité des plots** : le matelas s'adapte à la morphologie du patient, et réduit de façon efficace les effets de cisaillements.
- **Canaux d'aération entre les plots** : permettent la circulation de l'air et donc la ventilation du support, pour une diminution de l'effet de macération.
- **Un matelas moulé (≠ découpé)** : pour une mousse plus souple et plus résistante aux agressions extérieures.
- **Une surface de plot plus importante** : pour une surface de contact entre le patient et le support plus importante, ce qui permet de mieux répartir les pressions.

En 1 ou 3 sections et 5 largeurs

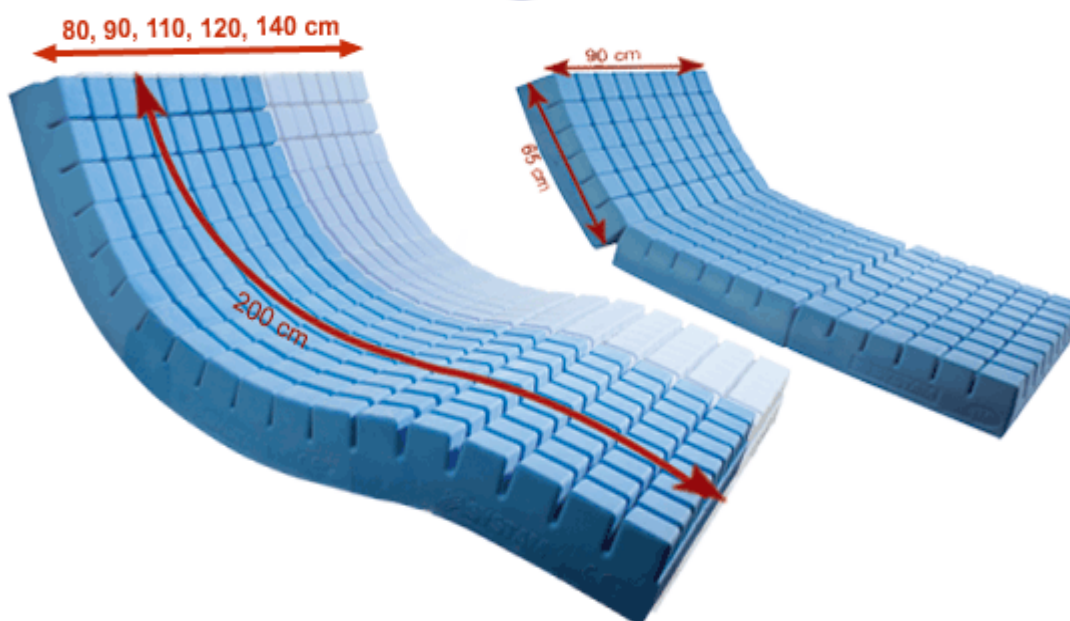

Specification

Modèle : POLYPL
Référence SYST'

Classe LPP : 1A
Renouvellement :
Code LPP : 1252€
1220€

Tailles Disponibles:

Version 1 partie

- 90 x 200 cm/

- 80 x 200 cm/

- 110 x 200 cm/

- 120 x 200 cm/

- 140 x 200 cm/

Version 3 partie:

- 90 x 200 cm/


Dr
int
An
SA
et
Cl

Alè
Po
An
et
Cl

La prescription

Conditions de prise en charge :

Patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur



l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué sur une autre échelle validée. Patients atteints de lésions médullaires.

A faire figurer dans l'ordonnance :

Mr ou Mme X présente un risque d'escarre de X sur l'échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état nécessite la délivrance d'un : Matelas Gaufrier POLYPLOT® P101M (ou P102M) SYST'AM - classe 1A.



SYSTEM

ZAE route de Casseneuil - Le Lédat - 47300 Villeneuve sur Lot - France

Tel.: 05 53 40 23 50 - Fax 05 53 40 50 40

commercial@system.com